

Pute : Vicair Adjuster O2 (OAD12)

Størrelse : \_\_\_\_\_ Tykkelse: 12 cm \_\_\_\_\_


Serie-nr. : \_\_\_\_\_

Navn på bruker : \_\_\_\_\_

Navn på behandler : \_\_\_\_\_

Dato : \_\_\_\_\_

Fyllingsgrad (antall SmartCells per kammer\*)

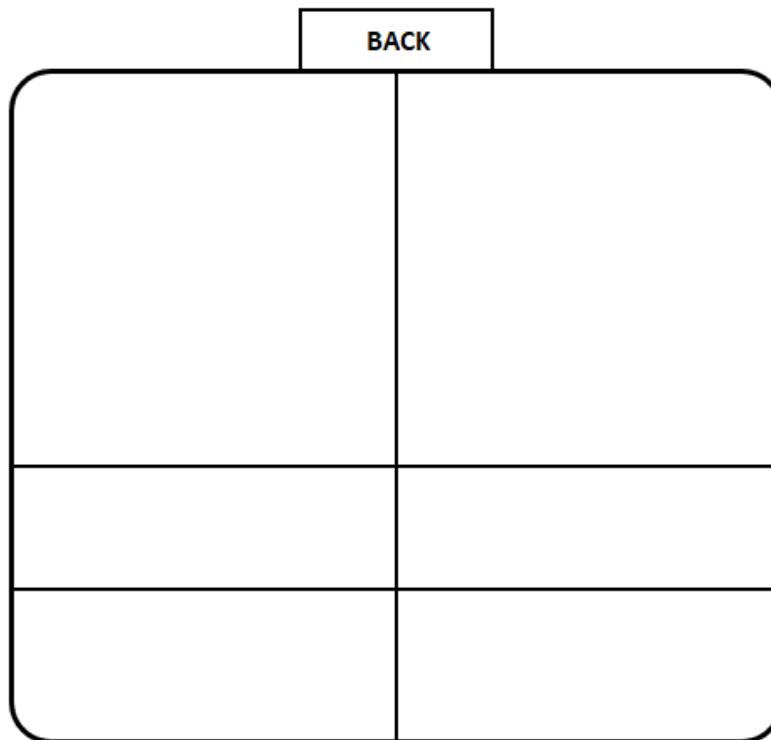

*\*Merk: Dette skjemaet viser den endrede/justerte fyllingsgraden. Standard fyllingsgrad, altså den opprinnelige fyllingsgraden, finner du på etiketten på selve puten.*

**Notater/kommentarer:**

**Ta godt vare på skjemaet til seinere bruk og referanse**

Vicair compartment layout form